

2017年4月吉日

取引先各位

製造販売元：株式会社カネカ
販売元：株式会社カネカメディックス

カネカインフレーションデバイス【QL2030】の三方活栓変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、製造元（アトリオンメディカル社（米国））での仕様変更により、下記のとおり三方活栓が変更される事となりましたのでご案内申し上げます。

なお、当該製品の使用方法、添付文書、ラベル表示を含む包装材料・形態等、その他の変更はございません。


今後とも、より一層のご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品： カネカインフレーションデバイス【QL2030】

変更点： 三方活栓の仕様変更

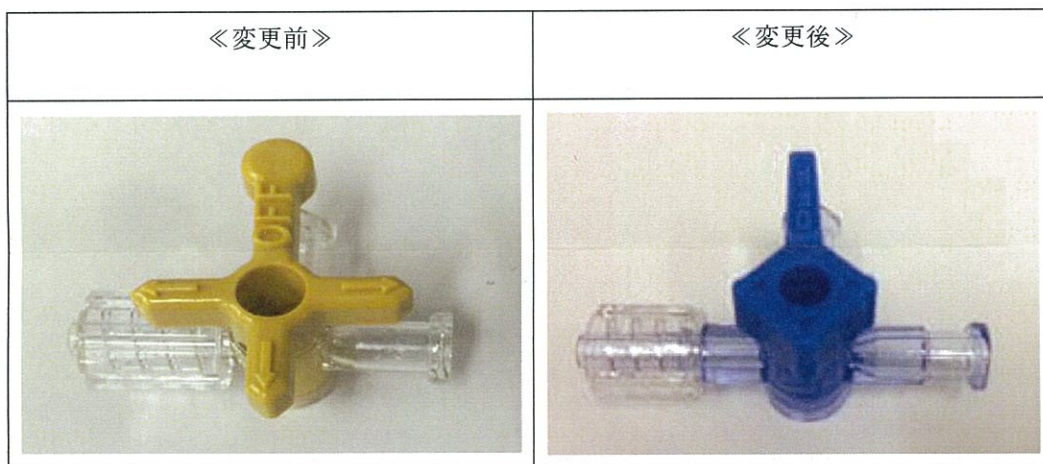

変更時期： 2017年5月以降（出荷状況により多少時期が変動することがございます）

以上