

2017年6月吉日

お客様各位

製造販売元：株式会社カネカ
販売元：株式会社カネカメディックス

エレクトロ デタッチ ジェネレーター v4 仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度エレクトロ デタッチ ジェネレーター v4（以下、EDG v4）を下記の通り、仕様変更いたしましたので、お知らせいたします。
また、合わせて包装箱も変更しております。
なお、カタログ番号、JAN コードに変更はございません。
何卒、ご了解賜り、引き続きのご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象製品】

エレクトロ デタッチ ジェネレーター v4 (EDG v4)

- カタログ番号：347-404
- JAN コード：4540778138797

【仕様変更時期】

2017年5月入庫製品から順次（ロット番号：KP047338より）

注）変更後も暫くは、現行品と仕様変更品が混在致します。

【仕様変更項目】

- 1) 対極板アダプター
- 2) 包装箱

【仕様変更理由】

1) 対極板アダプター

医療機器の電気製品安全基準「JIS T 0601-1 : 2012」に対応するため


2) 包装箱

国内用と輸出用の箱を統一するため


【仕様変更の詳細】

1) 対極板アダプター (EDGv4 アースクリップへの接続側)

(現行品)




(変更品)




<変更部分拡大図>

(現行品)




(変更品)




<EDG v4 アースクリップとの接続形態>

(現行品)




(変更品)



EDG v4 アースクリップ


- ※ 対極板アダプターは、EDG v4 のアースクリップに接続して出荷いたします。
対極板アダプターが不要の場合は、対極板アダプターを取り外してください。
その際、EDG v4 のアースクリップ先端を変形させないようにご注意ください。



EDG v4 のアースクリップを対極板アダプターのアースクリッププラグに掛けたままアースクリップを引くとアースクリップ先端の変形の原因になりますので、ご注意ください。

(出荷状態：アースクリップをアースクリッププラグに掛けた状態)

- ※ 取り外し例

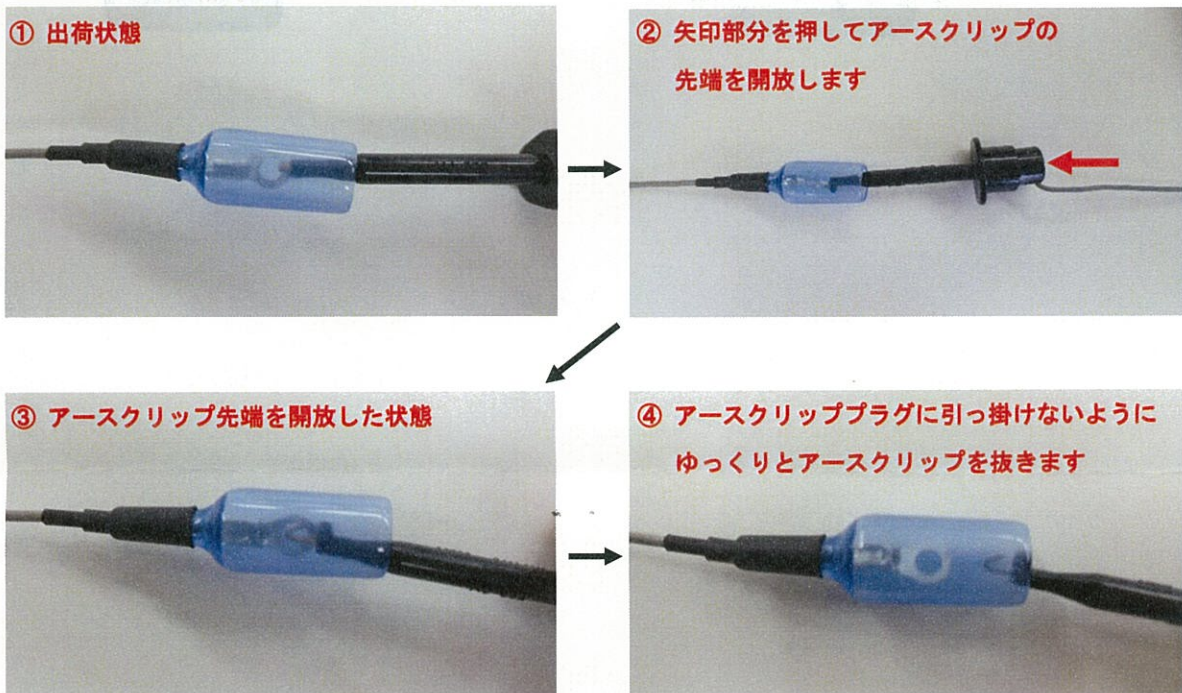


2) 包装箱

(現行)



(変更後)



以上