

お客様各位

マイホームピコセット®(TSCD®用) チューブホルダー仕様変更のご案内

2019年6月
テルモ株式会社

謹啓 平素よりテルモ製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、マイホームピコセット(TSCD用)につきまして、下記のとおりチューブホルダーの仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。


敬白

記



■ 変更内容

チューブホルダーの形状を変更いたします。

変更前

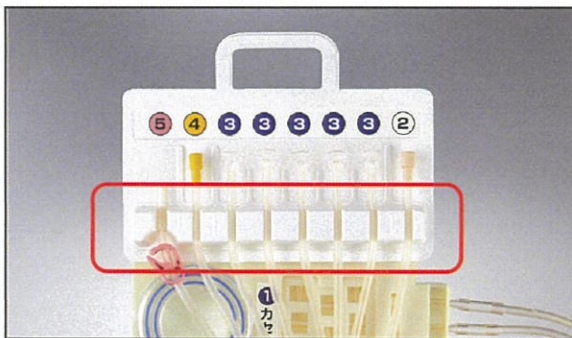

変更後

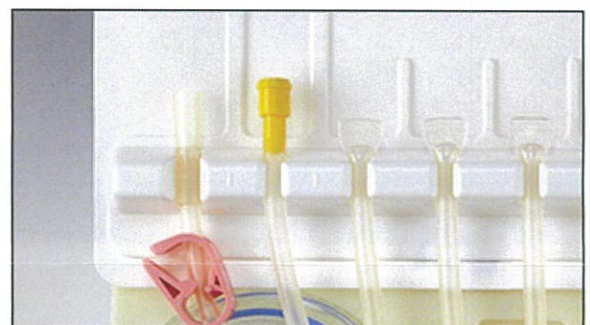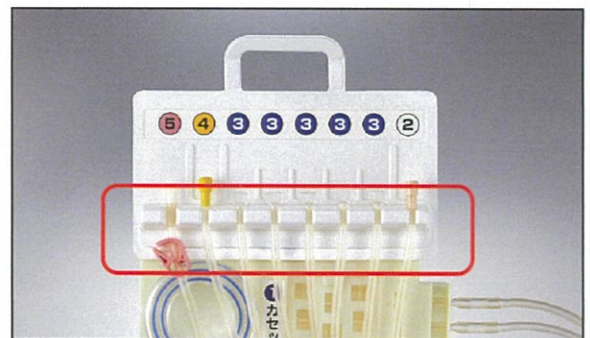

■ 変更開始時期

2019年8月頃

※在庫状況により変更品がお手元に届く時期が前後する場合がありますが、ご了承ください。

■ 変更対象品種

| 品名 | コード番号 | 仕様 | 包装単位 | 共通商品コード (JAN) | 開始ロット |
|------------|----------|---------------------------|------|---------------|---------|
| マイホームピコセット | CD-LH61T | APD回路 ピコセット (TSCD用) | 7セット | 4987350140999 | 190426A |

一般的名称：自動腹膜灌流装置用回路及び関連用具セット

販売名：マイホームピコセット 医療機器承認番号：21300BZZ00195

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp