

令和元年 11 月

お客様各位

MEERA 泉工医科工業株式会社
東京都文京区湯島 2-30-7
商品企画本部 麻酔部
TEL.03-3812-3254
FAX.03-3815-7011

メラ ソフィット クリア及びソフィットフレックスの スタイレット変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てに預かりまして厚く御礼申し上げます。

弊社気管切開チューブ「メラ ソフィット クリア」及び「ソフィットフレックス」のスタイレットの形状及び色の変更をいたします。つきましては従来品と識別する為、その外箱に「スタイレット変更品」のシールを暫くの間貼付いたします。

◆スタイレット変更内容

1.メラ ソフィット クリア(図 1 参照)

- ・ガイドワイヤ対応を目的として、スタイレットの形状及び先端部分に通し穴を追加
- ・スタイレット抜去の容易化を目的として、背面に突起物を追加

2.ソフィットフレックス(図 2 参照)

- ・メラ ソフィット クリアの識別を目的として青色から緑色に変更
- ・ガイドワイヤ対応を目的として、スタイレットの形状及び先端部分に通し穴を追加
- ・スタイレット抜去の容易化を目的として、背面に突起物を追加

※両製品の気管切開チューブ本体の仕様に関しては変更ございません

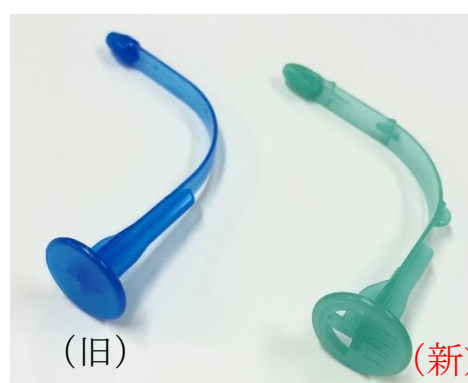


図 1.クリアのスタイレット(左 : 旧、右 : 新) 図 2.フレックスのスタイレット(左 : 旧、右 : 新)

◆スタイレット変更品のシール(図3参照)

外箱の法廷ラベルが貼られている面の裏面に「スタイレット変更品」のシールを貼付



メラ ソフィット クリア ソフィットフレックス ソフィットフレックス ショートタイプ
図3.シール貼付されたメラ ソフィット クリア及びフレックスフレックスの外箱

◆対象製品

- 1.メラ ソフィット クリア(全型式、紐付きタイプ(C-CS(T))、特注品)
- 2.ソフィットフレックス(全型式、ショートタイプ(FS-CS)、特注品)

◆出荷時期

- 1.標準品：2019年12月上旬
(型式により出荷時期が変動します)
- 2.受注生産品(特注品)：2020年2月前後

今後ともご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願ひ申し上げます。

敬具